

戊唑醇胶体金快速检测卡使用说明书

产品编号：YB113C01K

概要

戊唑醇(Tebuconazole)是一种高效、广谱、内吸收性的三唑杀菌剂，具有保护、治疗、铲除三大功能。主要用于防治小麦、水稻、花生、蔬菜、香蕉、苹果、梨以及玉米高粱等作物上的多种真菌病害。

检测原理

本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理，用于检测蔬菜、水果中戊唑醇残留。样本溶液滴入检测卡的加样孔后，样本溶液中的戊唑醇与金标抗体相结合，从而阻止金标抗体与纤维素膜上戊唑醇偶联物结合，通过 C、T 线的颜色深浅判断检测结果。

适用范围

本产品适用于新鲜蔬菜、水果等样本中戊唑醇残留的定性检测。

注：检测样本种类参照国标 GB2763-2021。

检测限

0.05 mg/kg (ppm)

试剂盒组成

序号	规格 组成	10 次/盒	20 次/盒	序号	工具名称		
(1)	检测卡(内含滴管、干燥剂)	10份	20份	(1)	天平（精度 0.01g）	(6)	涡旋仪
(2)	金标微孔	10孔/筒	20孔/筒	(2)	剪刀	(7)	计时器
(3)	戊唑醇稀释液	1瓶	2瓶	(3)	15mL/50mL 离心管		
(4)	20 mL刻度样品杯	1支	2支	(4)	移液器（0.2mL/1mL）		
(5)	5 mL离心管	10支	20支	(5)	镊子		
(6)	5 mL胶头滴管	1支	1支				
(7)	说明书	1份	1份				

注意事项

- 检测前处理样本的刀具、剪刀、粘板等工具应注意清洗，避免交叉污染。
- 样品要求：避免腐败变质样品；避免大块泥土（可以甩掉或用其他洁净物品擦除）。
- 检测前建议样品充分搅拌均匀（若取样少则应取代表性部位，再进行称样），这样检测结果才能更真实反应样品实际药物残留情况。
- 检测环境温度应控制在20~30℃，温度过高或过低会影响检测结果。
- 请按照检测步骤进行测试，操作时请勿触摸试纸条显色区，避免阳光直射和电风扇直吹。
- 待检样品溶液需澄清，否则容易导致显色不明显等异常现象，影响实验结果判定。
- 过期或铝箔袋破损的产品均不可使用，拆封后的检测卡请立即使用。
- 样本处理后请尽快使用，时间过长则需要重新处理样本再检测。
- 出现阳性结果时建议复测，本产品检测结果仅供参考，如需确证，请参照国家相关标准方法。
- 加标验证时，标液溶剂一般选择甲醇，最终样本加标量建议在10-50 μL。
- 直接测试标准品时溶剂用试剂盒配套的提取液，有机溶剂加入量控制在1%以内，自来水、蒸馏水、纯净水或去离子水不能作为阴性对照。

安全性说明

- 实验需匹配相应的实验设备和穿戴必需的实验装备(白服、手套、口罩等)。
- 检测试剂盒需妥善保存请，放在儿童不易接触的地方。
- 实验后要保持实验室的整洁和实验环境空气的流通性。
- 本产品为一次性产品，检测完毕后应妥善处理，实验废弃物单独收集，建议按照医疗废弃物处理。
- 本产品所涉及的试剂安全可靠，不含致癌性，剧毒、易燃、易爆、强腐蚀性的试剂，但不得食用。

贮藏条件及有效期

- 原包装：于2-30℃避光干燥保存，勿冷冻，有效期12个月。
- 拆封后：检测卡拆封后立即使用，勿冷冻。


戊唑醇胶体金快速检测卡操作步骤

样本前处理步骤

(1) 检测前样品需恢复至室温 (20-30℃)，取适量样本，剪切为 1 厘米见方的碎片。



(2) 称取 2 g 样品于样品杯或 15 mL 离心管中，加入 5 mL 稀释液。

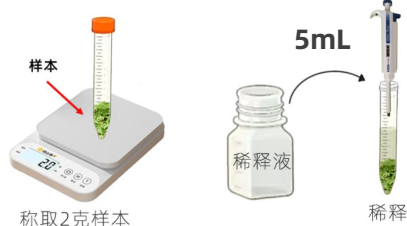

(3) 涡旋仪涡动或手动上下振摇 2 分钟，静置 1 分钟，得样品液；按下表将样品液与稀释液按不同比例稀释，稀释后的溶液为待测液。




不同样品的稀释方法及限量值


样本分类	样品名称	样品液(μL)+稀释液(μL)	国标限量 GB2763-2021
蔬菜类	花椰菜		
	大蒜、洋葱、茄子		
	青花菜、西葫芦		
	孢子甘蓝		
	胡萝卜		
	葱		
	玉米笋、朝鲜蓊		
	韭葱		
	萝卜、甜椒、黄瓜、结球甘蓝	200+200	1 mg/kg
	番茄、苦瓜、辣椒	100+300	2 mg/kg
水果类	荚可食豆类蔬菜	100+200	1.5 mg/kg
	结球莴苣		
	大白菜		
	萝卜叶		
	芹菜		
	橄榄、芒果	120+120	0.05 mg/kg
	西瓜、西番莲		
	甜瓜类水果		
	枇杷		
	梨、山楂、榲桲		
	李子		
	桑葚		
	柑、橘、橙、苹果、桃、油桃、杏、葡萄、番木瓜、草莓		
	香蕉		
	樱桃		
	猕猴桃		

样本检测步骤


(1) 从原包装袋中取出检测卡、金标微孔和滴管，放于平整、洁净的台面上。



(2) 用移液器或滴管吸取 120 μL (约 4 滴) 待测液，滴加到金标微孔中，用滴管或移液器反复吸打以溶解微孔中的红色物质，等待反应 2 分钟。



(3) 吸取微孔中全部液体垂直缓慢滴加到检测卡的加样孔 (S) 中；液体流动时开始计时，反应 8~10 分钟，根据示意图判定结果，其他时间判定无效。




结果判断

目测：

阴性（未检出）：T 线颜色比 C 线颜色深或者一样深；

阳性（检出）：T 线颜色比 C 线浅或者 T 不显色；

无效：C 线不显色且无论 T 线是否显色。



阴性	阳性	无效	仪器判读：详见仪器使用说明书
----	----	----	----------------