

沙丁胺醇（Clen）检测卡（组织） 使用说明书

【产品简介】

本产品为沙丁胺醇肌肉组织残留检测卡，整个检测过程只需5分钟~10分钟，检测限为5ng/mL(ppb)，适用于各类企业及检测机构。

【产品组成】

沙丁胺醇检测卡	25份/盒
样品提取液	1瓶/盒
说明书	1份/盒


【样品处理】

- 将待检样本去皮去脂肪去筋膜后匀浆；
- 准确称取1.00 g±0.05 g匀浆后的肌肉组织样品于10 mL离心管中；
- 加入1 mL样品提取液，涡动1 min；室温4000 rpm离心10min后，小心取出离心管，待检。

【使用步骤】

- 测试前先完整阅读使用说明书，并将检测卡和待检样本溶液恢复至室温(20°C~30°C)。
- 从包装袋中取出检测卡平放于桌面，撕开包装袋后请尽快使用；
- 用滴管小心吸取离心管中上清液，加3滴(约80μL)于样品孔(S孔)中；
- 加样后5分钟~10分钟，观察显色区判定结果，超过15分钟的判读无效。

【结果判断】

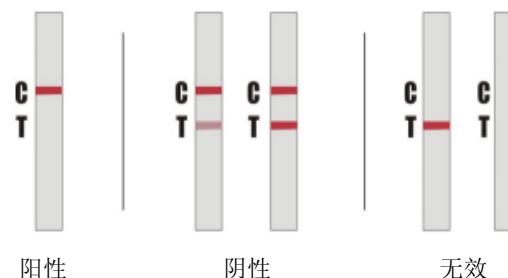

阴性(-)：C、T线均显色，表明样品中沙丁胺醇含量低于检测限或不含沙丁胺醇；

阳性(+)：C线显色，T线不显色或接近无色，表明样品对应的沙丁胺醇含量等于或高于检测限；

无效：未出现C线(对照线)，可能是操作不当或检测卡已失效。应再次仔细阅读说明书，并用新的检测卡重新测试。

【灵敏度】

沙丁胺醇(Clen)：5ng/mL

【特异性】

本产品与链霉素、四环素、氯霉素、磺胺类等药物无交叉反应。

【注意事项】

- 试剂盒切勿冷冻保存，不要存放4°C冰箱，避免阳光直射，检测样本恢复至室温再进行检测；
- 请勿触摸检测卡中央的白色膜面；
- 滴加、吸取待检样品时，请使用本产品附带滴管，滴管不能混用，以免交叉污染
- 检测卡启封后，请尽快使用；
- 样品提取液不能作为阴性对照；
- 离心后上清液中杂质太多，可适当延长离心时间；
- 本检测卡为一次性产品，请勿重复使用；
- 本检测卡仅用于初筛，最终结果以仪器方法确证为准。

【储存条件】

4°C~25°C阴凉干燥处保存，切勿冷冻。

【有效期】

12个月。

【生产日期及批号】

详见包装盒。